



САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ
САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
11 000 Београд, Мике Аласа 14, поштански фах 384
телефон: (011) 328 - 2736, телефакс: (011) 181-668

На основу члана 36. став 1. Закона о мерним јединицама и мерилима ("Службени лист СРЈ", бр. 80/94, 28/96 и 12/98), а на захтев ЕНЕЛ д.о.о., Београд, Звечанска 1, Савезни завод за мере и драгоцене метале доноси

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

Назив мерила:	Монофазно вишефункцијско бројило електричне енергије
Ознака основног типа:	ДБ2М
Произвођач мерила:	ЕНЕЛ д.о.о., Београд
Службена ознака типа:	F - 6 - 58
Рок важања решења:	08.05.2012. године

Испитивањем типа мерила утврђено је да мерило испуњава метролошке услове прописане Правилником о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије класе тачности 1 и 2 ("Службени лист СФРЈ", бр. 09/92), Правилником о метролошким условима за статичка (електронска) бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 ("Службени лист СРЈ", бр. 47/98) и Правилником о метролошким условима за показиваче максимума класе 1,0 ("Службени лист СФРЈ", бр. 56/89).

Број: 2/4-01-1618
Београд, 08.05.2002. године

ДИРЕКТОР

Мр Драган Милошевић



СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ
ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
11000 Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384,
тел. (011) 32-82-736, телефакс: (011) 181-668

На основу члана 36. став 1. Закона о мерним јединицама и мерилима ("Службени лист СРЈ", бр. 80/94, 28/96 и 12/98), а на захтев ЕНЕЛ д.о.о., Звечанска бр. 1, Београд, Завод за мере и драгоцене метале доноси

РЕШЕЊЕ

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

1. Решење о одобрењу типа мерила број: 2/3-01-1618 од 08.05.2002., којим се одобрава да се на први преглед могу подносити мерила:

Назив мерила:	Монофазно вишефункцијско бројило електричне енергије
Ознака основног типа:	ДБ2М
Произвођач мерила:	ЕНЕЛ, Београд
Службена ознака типа:	Ф - 6 - 58
Рок важања решења:	08.05.2012. године

допуњава се: опсегом електричне струје, повећањем броја тарифа и постављањем уклопног часовника.

2. Допунским испитивањем типа мерила утврђено је да мерила испуњавају метролошке услове прописане Правилником о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије класе тачности 1 и 2 ("Службени лист СФРЈ", бр. 9/92), услове прописане Правилником о метролошким условима за статичка бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 ("Службени лист СРЈ", бр. 47/98), услове прописане Правилником о метролошким условима за показиваче максимума класе 1, ("Службени лист СФРЈ", бр. 56/89) и услове прописане Правилником о метролошким условима за уклопне часовнике, ("Службени лист СФРЈ", бр. 3/85).

Број: 2/4-01-2665
Датум, 24.07.2003. године



РЕКТОР

мр Јан Милошевић



СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ
ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
11000 Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384,
тел. (011) 32-82-736, телефакс: (011) 181-668

На основу члана 36. став 1. Закона о мерним јединицама и мерилима ("Службени лист СРЈ", бр. 80/94, 28/96 и 12/98), а на захтев ЕНЕЛ д.о.о., Петроварадинска бр. 26, Београд, Завод за мере и драгоцене метале доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

1. Решење о одобрењу типа мерила број: 2/3-01-1618 од 08.05.2002., којим се одобрава да се на први преглед могу подносити мерила:

Назив мерила:	Монофазно вишефункцијско бројило електричне енергије
Ознака основног типа:	ДБ2М
Произвођач мерила:	ЕНЕЛ, Београд
Службена ознака типа:	F - 6 - 58
Рок важања решења:	08.05.2012. године

допуњава се опсегом електричне струје и могућношћу коришћења шанта за опсег електричне струје 60 А.

2. Допунским испитивањем типа мерила утврђено је да мерила испуњавају метролошке услове прописане Правилником о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије класе тачности 1 и 2 ("Службени лист СФРЈ", бр. 9/92), услове прописане Правилником о метролошким условима за статичка бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 ("Службени лист СРЈ", бр. 47/98), услове прописане Правилником о метролошким условима за показиваче максимума класе 1, ("Службени лист СФРЈ", бр. 56/89) и услове прописане Правилником о метролошким условима за уклопне часовнике, ("Службени лист СФРЈ", бр. 3/85).

Број: 2/4-01-5926
Датум: 20.12.2004. године





СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ
ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
11000 Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384
тел. (011) 32-82-736, телефакс: (011) 2181-668

На основу члана 9. став 1.и члана 12. Закона о метрологији ("Службени лист СЦГ", бр. 44/2005), а на захтев ЕНЕЛ д.о.о., Петроварадинска бр. 26, Београд, Завод за мере и драгоцене метале доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА


1. Решење о одобрењу типа мерила број: 2/3-01-1618 од 08.05.2002. године, којим се одобрава да се на први преглед могу подносити мерила:

Назив мерила:	Једнофазно бројило електричне енергије
Ознака основног типа:	ДБ2М
Произвођач мерила:	ЕНЕЛ, Београд
Службена ознака типа:	F - 6 - 58
Рок важања решења:	08.05.2012. године

допуњава се: модуларном израдом и новим кућиштем, према прилогу.

2. Допунским испитивањем типа мерила утврђено је да мерила испуњавају метролошке услове прописане Правилником о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије класе тачности 1 и 2 ("Службени лист СФРЈ", бр. 9/92), Правилником о метролошким условима за статичка бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 ("Службени лист СРЈ", бр. 47/98), Правилником о метролошким условима за показиваче максимума класе 1, ("Службени лист СФРЈ", бр. 56/89) и Правилником о метролошким условима за уклопне часовнике, ("Службени лист СФРЈ", бр. 3/85).

Број: 2/4-01-2368
Београд: 17.04.2006. године





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

11000 Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384
тел. (011) 32-82-736, телефакс: (011) 2181-668

На основу члана 9. став 1. и члана 12. Закона о метрологији ("Службени лист СЦГ", бр. 44/2005), а на захтев ЕНЕЛ д.о.о., Петроварадинска бр. 26, Београд, Дирекција за мере и драгоцене метале доноси:

РЕШЕЊЕ

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

1. Решење о одобрењу типа мерила број: 2/3-01-1618 од 08.05.2002. године, којим се одобрава да се на први преглед могу подносити мерила:

Назив мерила:	Монофазно вишефункцијско бројило електричне енергије
Ознака основног типа:	ДБ2М
Произвођач мерила:	ЕНЕЛ д.о.о., Београд
Службена ознака типа:	F - 6 – 58
Рок важења решења:	08.05.2012. године

допуњава се: новим кућиштем, према прилогу.

2. Допунским испитивањем типа мерила утврђено је да мерила испуњавају метролошке услове прописане Правилником о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије класе тачности 1 и 2 ("Службени лист СФРЈ", бр. 9/92), Правилником о метролошким условима за статичка бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 ("Службени лист СРЈ", бр. 47/98), Правилником о метролошким условима за показиваче максимума класе 1, ("Службени лист СФРЈ", бр. 56/89) и Правилником о метролошким условима за уклопне часовнике, ("Службени лист СФРЈ", бр. 3/85).

Број: 2/4-01-1865
Датум: 29.05.2007. године




ПРИЛОГ РЕШЕЊУ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ТИПА
БРОЈ: 2/4-01-1865

1. МЕТРОЛОШКА СВОЈСТВА


Тачка 1.5. Основне карактеристике конструкције и функционалност мерила допуњава се:

Изглед једнофазног бројила основне ознаке типа ДБ2М у новом кућишту, приказан је на слици 3 б.

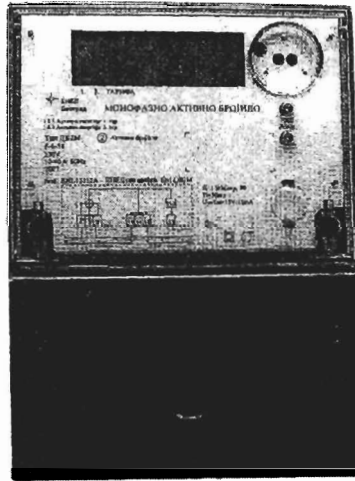

Слика 3 б. Изглед бројила основне ознаке типа ДБ2М у новом кућишту

Димензије новог кућишта бројила основне ознаке типа ДБ2М приказане су на слици 4 б.

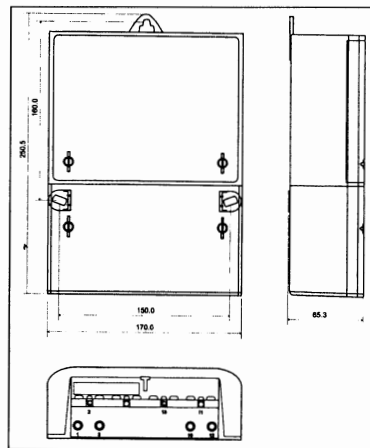

Слика 4 б. Димензије новог кућишта бројила основне ознаке типа ДБ2М

